



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00016/2022 – FMS-PMBEX**

**ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 00037/2022 –
FMS – PMBEX:
EMPRESA
EQUIPASAÚDE
PRODUTOS PARA
SAÚDE LTDA, CNPJ:
34.836.183/0001-00**



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 000.37/2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX – FMS - PMBEX

Aos dez dias do mês de maio do ano de 2022, a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bayeux, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede Rua Flávio Maroja, s/n - Centro, Bayeux-Pb - 58306-390, neste ato representada pela Sr(a). Rosiene Sarinho Soares Ribeiro, brasileira, RG: 4.883.595, CPF: 885.106.204-82, residente e domiciliada à Rua Manoel Cesar Alencar, nº 374 – Aeroporto – Bayeux/PB, CEP: 58.308-070, gerenciadora da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP), decorrente da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00016/2022 – FMS-PMBEX, cujo objetivo fora a formalização de REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE APARELHO DE RAIOS X, DIGITALIZADOR DO TIPO CR E IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, processada nos termos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00043/2022 – FMS-PMBEX a qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, conforme o disposto no art. 15 da Lei nº 8.666/93, segundo as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. A presente estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE APARELHO DE RAIOS X, DIGITALIZADOR DO TIPO CR E IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, cujos quantitativos, especificações, preços, e fornecedores foram previamente definidos através do procedimento licitatório em epígrafe.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES

2.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Bayeux, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Rua Flávio Maroja, s/n - Centro, Bayeux-Pb - 58306-390, inscrita no CNPJ nº 08.924.581/0004-02, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR;

2.2. **Parágrafo único** – qualquer órgão ou entidade de qualquer esfera da Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação em epígrafe, observadas as exigências contidas no Decreto Municipal nº 030/2019, de 16 de julho de 2019.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Comissão Permanente de Licitação, obriga-se a:

3.1. Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, os nomes dos fornecedores, os preços, os quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;

3.2. Convocar os particulares via fax, telefone ou e-mail, para assinatura da ARP, assinatura do contrato e retirada da nota de empenho;

3.3. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;

3.4. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades;

14

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

- 3.5. Realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;
- 3.6. Consultar os fornecedores registrados (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecimento do (s) material (ais) a outro (s) órgão (ãos) da Administração Pública que externe (m) a intenção de utilizar a presente ARP;
- 3.7. Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente ARP;
- 3.8. Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes;
- 3.9. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação durante a execução contratual, na presente ARP.

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE PRÉVIO E DO PARTICIPANTE A POSTERIORI;

O **ÓRGÃO PARTICIPANTE** e o **ÓRGÃO PARTICIPANTE A POSTERIORI**, através de gestor próprio indicado, obrigam-se a:

- 4.1. Tomar conhecimento da presente ARP, inclusive as respectivas alterações, para fins de utilização de forma correta da mesma;
- 4.2. Consultar, previamente, o **ÓRGÃO GERENCIADOR** objetivando a obtenção das informações necessárias à aquisição pretendida;
- 4.3. Verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, informando ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** eventuais desvantagens verificadas;
- 4.4. Encaminhar ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** a respectiva nota de empenho;
- 4.5. Enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;
- 4.6. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente ARP, informando ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular.

5. CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

O **FORNECEDOR** obriga-se a:

- 5.1. Assinar a ARP, assinar o contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação, e retirar a respectiva nota de empenho, no que couber;
- 5.2. Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP;
- 5.3. Entregar o (s) material (ais) solicitado (s) nos prazos estabelecidos no edital;
- 5.4. Fornecer o (s) material (ais) conforme especificações, marcas, e preços registrados na presente ARP;
- 5.5. Entregar o (s) material (ais) solicitado (s) no respectivo endereço do órgão participante Prévio ou participante a Posteriori da presente ARP;
- 5.6. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR** referente às condições firmadas na presente ARP;
- 5.7. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
- 5.8. Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
- 5.9. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante (s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;

Handwritten mark

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

5.10. Pagar, pontualmente, o (s) fornecedor (es) e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao (s) material (ais) entregue (s), com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;

5.11. Apresentar, quando da assinatura deste instrumento, planilha de formação de preços atualizada contendo a distribuição proporcional dos valores finais ofertados na sessão de licitação, após os lances, se for o caso;

6. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de um ano, a contar da data da sua assinatura, vigorando até o dia dez de maio de 2023.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Os preços, as quantidades, o (s) fornecedor (es) e as especificações do (s) material (ais) registrados nesta Ata encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório.

7.2. Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.

EMPRESA: EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ: 34.836.183/0001-00

ENDEREÇO: AV. FELICIANO BATISTA AMORIM, 1116, BAIRRO JUÁ, GUARABIRA-PB, CEP: 58.200-000, TEL.: (83) 3271-3480, E-MAIL: EQUIPASAUDE@OUTLOOK.COM

RESPONSÁVEL: ELDER DA COSTA CARVALHO, RG: 529424095 SSP/PB, CPF: 381.998.868-89

LOTE ÚNICO						
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNID	FABRICANTE/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	RAIO X HOSPITALAR FIXO 600MA: MESA DE COMANDO: Mesa de comando microprocessada com teclado Soft-touch e display de LCD modelo Big Number para uma fácil leitura dos parâmetros radiológicos. Tecla de liga/desliga Teclado com comando duplo de seleção de Kv, kV maior com variação em passos de 10kV aproximadamente kV menor com variação em passos de 2kV aproximadamente Seleção de tempo em 21 passos variando de 0,04s a 3,2 s Seleção de mA com os seguintes valores Foco fino: 50 /100 mA Foco grosso : 200 / 320 /400 / 500/ 630 mA Seleção automática de foco conforme a escala de corrente selecionada Seleção de Postos de Trabalho: Coluna(sem Bucky) Bucky1 (Bucky mural) Bucky2 (mesa Bucky) Teclapradisparo de Raios – X; Tecla para preparo de RX Demais características Circuito de estabilização de voltagem para filamento de ampola; Bloqueio de técnicas de operações prejudiciais a ampola; Aviso sonoro e luminoso em caso de bloqueios e durante a exposição. TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO: Rendimento de 630 mA / 125 KV; Imerso em óleo isolante especial, tratado a vácuo; Unidades	01	UND	SHR/SH 600F	R\$ 144.000,00	R\$ 144.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

<p>retificadoras de silício para 125 KVp onda completa; Receptáculo Universal tipo "Federal Standard". CABOS DE ALTA TENSÃO: 01 Par de Cabos de Alta Tensão; Capacidade 150 KVp, com terminais de conexões Universal tipo "Federal Standard". AMPOLA PRODUTORA DE RAIOS – X: Tubo de anodo giratorio (30 / 50 KW) angulação de 16 graus; Capacidade máxima de armazenamento de calor: 190kHU; Dissipação térmica contínua máxima: 490 W ; Filamento: Foco Fino: 1,0/ 1,0 mm, Foco Grosso: 2,0/ 2,0 mm, Cúpula Radiação de fuga: < 0,5 mGy/h / 125 kV, Conexão tipo Federal. Cargas máximas permitidas: 630mA / 80kV, 500 mA / 90 KV 100 mA / 115 KV, 300 mA / 100 KV 50 mA / 125 KV, 200 mA / 110 KV. COLIMADOR LUMINOSO: Caixa com revestimento em chumbo. Lâminas em 1 estágio. Lâmpada halógena de 24 volts. Contraste superior a 3:1 Temporizador eletrônico para centralização. COLUNA PORTA TUBO: Coluna porta tubo dotada de freios eletromagnéticos acionados por meio de teclas. Indicador de angulação, braço telescópico com giro de 180 graus. Coluna co base giratória contrabalançada com deslocamento sobre trilho, sistema chão / chão dotado de freios eletromagnéticos. Braço de sustentação do Tubo com movimento de avanço e retrocesso com freio magnético. ESTATIVA BUCKY MURAL: Coluna contrabalançada para fixação em chão. Freios mecânicos e eletromagnéticos. Grade anti-difusora 10.1-150 linhas, com distância focal 1,80 mts. Bandeja ajustável em aço inox polido para chassis 13X18 até 35X43 cm. Ligaçao conjugada com o Comando do equipamento com disparo de Raios- X automático. MESA RADIOLÓGICA: Mesa Bucky TAMPO FLUTUANTE com movimentos longitudinais e transversais provida de freio magnético, com acabamento em pintura eletrostática, tampo em fórmica e acabamento em alumínio A-7, provida de bucky com gaveta em aço inox polido e percurso em toda sua extensão. Grade anti-difusora 10.1-150linhas. ALIMENTAÇÃO DE REDE: 220 – Volts- Hz/ Bifásico. EXAMES QUE PODERÃO SER REALIZADOS COM ESTE APARELHO: Radiografia convencional. Traumatologia e Ortopedia em geral. Incidências Oblíquas (todas). Urografia escretora. Vias Biliares. Seios da Face Mastóide. Dissipação térmica contínua máxima: 490 W ; Filamento: Foco Fino: 1,0/ 1,0 mm, Foco Grosso: 2,0/ 2,0 mm; Cúpula Radiação de fuga: < 0,5 mGy/h / 125 kV, Conexão tipo Federal. Cargas máximas permitidas:</p>					
--	--	--	--	--	--

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

<p>630mA / 80kV, 500 mA / 90 KV 100 mA / 115 KV, 300 mA / 100 KV 50 mA / 125 KV, 200 mA / 110 KV. COLIMADOR LUMINOSO: Caixa com revestimento em chumbo. Lâminas em 1 estágio. Lâmpada halógena de 24 volts. Contraste superior a 3:1 Temporizador eletrônico para centralização. COLUNA PORTA TUBO: Coluna porta tubo dotada de freios eletromagnéticos acionados por meio de teclas. Indicador de angulação, braço telescópico com giro de 180 graus. Coluna co base giratória contrabalançada com deslocamento sobre trilho, sistema chão / chão dotado de freios eletromagnéticos. Braço de sustentação do Tubo com movimento de avanço e retrocesso com freio magnético. ESTATIVA BUCKY MURAL: Coluna contrabalançada para fixação em chão. Freios mecânicos e eletromagnéticos. Grade anti-difusora 10.1-150 linhas, com distância focal 1,80 mts. Bandeja ajustável em aço inox polido para chassis 13X18 até 35X43 cm. Ligação conjugada com o Comando do equipamento com disparo de Raios- X automático. MESA RADIOLÓGICA: Mesa Bucky TAMPO FLUTUANTE com movimentos longitudinais e transversais provida de freio magnético, com acabamento em pintura eletrostática, tampo em fórmica e acabamento em alumínio A-7, provida de bucky com gaveta em aço inox polido e percurso em toda sua extensão. Grade anti-difusora 10.1-150linhas. ALIMENTAÇÃO DE REDE: 220 - Volts- Hz/ Bifásico. EXAMES QUE PODERÃO SER REALIZADOS COM ESTE APARELHO: Radiografia convencional. Traumatologia e Ortopedia em geral. Incidências Oblíquas (todas). Urografia escretora. Vias Biliares. Seios da Face Mastóide. INSTALAÇÃO E TREINAMENTO INCLUSO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA VIGENTE.</p>				
<p>CR DIGITALIZADOR DE IMAGEM: Sistema de digitalização de imagens de alta resolução, com alimentador mono cassete, com possibilidade de resolução de 06 pixels/mm em modo padrão e 12 pixels/mm em alta resolução. O sistema digitalizador deverá possuir capacidade de: Reconhecer automaticamente o tamanho e tipo do cassete; Reconhecer automaticamente o tamanho e tipo do cassete; 35x43cm, em resolução padrão; ESTAÇÃO DE TRABALHO para imagens de Raios X: Conter software de processamento de exames de Raios-X e software adicional de pós-processamento de imagens que permita, a critério do operador e de forma manual ou automática,</p>				

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

02	<p>incrementar o contraste da imagem. Efetuar automaticamente o enegrecimento da borda da imagem digitalizada que não recebeu radiação. Ferramentas de ajustes de brilho, contraste, índice de exposição, medidas de distâncias, ângulos, rotação, inversão, zoom e formatação de imagens para impressão. Suprimir automaticamente linhas de grades nas imagens. Marcar automaticamente imagens que foram rotacionadas e invertidas. Efetuar conexão DICOM 3.0 para impressão Print. Possibilitar ao operador a capacidade de escolher multi layouts de impressão para permitir economia de filmes. Permitir o cadastramento de imagens de Raios-X e sistema de identificação integrado ao terminal, para cadastramento dos cassetes. Permitir comunicação e arquivamento de, no mínimo, 2.000 imagens na forma online. Armazenar e distribuir imagens em formatos DICOM 3.0 com níveis de visualizações (diagnóstica e referência) via rede existente, em TCP/IP, LAN e WAN. 2 Cassetes + Placa de fósforo 35 x 43 cm para radiologia computadorizada; Software baseado em plataforma WEB, com disponibilização de, no mínimo, 4 pontos de acesso remoto e simultâneos para visualização das imagens via intranet ou internet (WEB VIEWER). Capacidade para gravação de imagens em DVD em formato que permita sua visualização em um PC padrão, sem necessidade de software adicional. Possibilitar uso de senhas individuais de acesso, com definição de privilégios, para proteção de dados confidenciais. Possuir software Multilayout, Possibilitando ao operador a capacidade de formatar a impressão de, no mínimo, 04 imagens de resolução diagnóstica na mesma película e selecionar tamanhos diferentes de película, podendo ser de formatos e tamanhos diferentes. PC/MONITOR: PLACA MAE 1150 PCWARE IPMH81G1 DDR3, PROCESSADOR 1150 INTEL CORE I5 4460 3.20GHZ 6MB, MEMÓRIA 8GB DDR3 1600MHZ, HD 1TB WD BLUE 7200RPM SATA3, GABINETE, WINDOWS 10 PROFISSIONAL 64 BITS, TECLADO/MOUSE. NO-BREAK'S 2 KVA SENOIDAIS DUPLA CONVERSÃO: ENTRADA/SAÍDA: 220V ou BIVOLT, ON-LINE- SÉRIE COM SAÍDA SENOIDAL; DISTORÇÃO HARMONICA TDH <5%, PFC E CARGA NÃO LINEAR; FREQUENCIA NOMINAL: 60 Hz +/- 5%, REGULAÇÃO NORMAL : +/- 2%, REGULAÇÃO NA BATERIA: +/- 3%, POSSUIR TRANSFORMADOR ISOLADOR. INSTALAÇÃO E TREINAMENTO INCLUSO.</p>	01	UND	CARESTREAM / DIRECTVIEW VITA FLEX	R\$ 116.000,00	R\$ 116.000,00
----	--	----	-----	-----------------------------------	----------------	----------------

R

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA VIGENTE.					
03	IMPRESSORA COM TECNOLOGIA de impressão LASER a seco (DRY): Sistema de Imagem Direta Digital tecnologia de impressão a laser: Possua resolução mínima de 320 DPI e tecnologia de impressão a laser; Processamento de no mínimo 40 filmes por hora, do tamanho 35x43 cm; Imprimir filmes nos tamanhos 20x25cm, 25x30cm, 28x35cm e 35x43cm; O equipamento deverá ser DICOM NATIVO, ou seja, sem a necessidade de acessórios externos (print server) para conversão do sinal ao padrão DICOM 3.0; Permitir conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0 e Ethernet TCP/IP; Alimentação 220 volts, 60 Hertz. INSTALAÇÃO E TREINAMENTO INCLUSO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA VIGENTE.	01	UND	CARESTREAM / DRYVIEW 5700	RS 31.000,00	RS 31.000,00
VALOR GLOBAL:						RS
(DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL REAIS)						291.000,00

7.3. O valor total da presente Ata de Registro de Preços é de **RS 291.000,00 (duzentos e noventa e um mil reais)**.

8. CLÁUSULA OITAVA – DOS PROCEDIMENTOS PARA FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

8.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR durante a vigência do presente Registro de Preços poderá mediante as suas necessidades efetivar as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços através da assinatura de um instrumento contratual, após a plena vigência e eficácia do mesmo, e mediante a emissão de empenho, que será entregue ao fornecedor contratado para o fornecimento, obedecidas as normas contidas no instrumento convocatório.

8.2. O empenho é o documento competente para firmar o compromisso de fornecimento com o fornecedor.

9. CLÁUSULA NONA – DA CONDIÇÃO ESPECÍFICA

9.1. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR, nem o ÓRGÃO PARTICIPANTE, se for o caso, a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, em caso de igualdade de condições, a preferência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICIDADE

10.1. Os preços, os quantitativos, o(s) fornecedor (es) e as especificações resumida (s) do objeto, como também as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas em imprensa oficial, na forma de extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei nº. 8.666/93.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA REVISÃO DE PREÇOS

11.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93;

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

11.1.1. Parágrafo único – a qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, ou de fato novo que eleve o seu custo, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as necessárias negociações junto aos fornecedores para negociar o novo valor compatível ao mercado.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

O FORNECEDOR terá seu registro cancelado nos seguintes casos:

12.1 O Fornecedor Registrado terá o seu registro cancelado quando:

- 12.1.1. Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais;
 - 12.1.2. Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
 - 12.1.3. Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado;
 - 12.1.4. Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
 - 12.1.5. Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em relatório da fiscalização;
 - 12.1.6. Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/DETENTOR DA ATA, mediante comunicação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do compromisso do fornecimento;
 - 12.1.7. Por decurso de prazo de vigência;
 - 12.1.8. Não restarem fornecedores registrados;
 - 12.1.9. Não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;
 - 12.1.10. Não realizar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
 - 12.1.11. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata decorrente de Registro de Preços;
 - 12.1.12. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR REGISTRADO recusar-se a abaixá-los, após solicitação expressa da Secretaria;
 - 12.1.13. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração Pública;
 - 12.1.14. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste Cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem do Registro de Preços;
 - 12.1.15. A solicitação referida na alínea “n” desta cláusula deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso não aceitas as razões do pedido, sendo assegurada ampla defesa da licitante, nos termos da Lei nº 8.666/93.
 - 12.1.16. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação será feita por publicação em Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da publicação.
- 12.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução do objeto deste Edital, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente ata, garantida a **prévia defesa** e o **contraditório**, ficará o particular sujeito às seguintes sanções, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seu(s) ato(s) ensejar(em):

- 13.1. Advertência;
- 13.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, no caso de inexecução total da obrigação assumida;
- 13.3. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, quando a **licitante vencedora**, injustificadamente, ou por motivo não aceito pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE**

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

BAYEUX, deixar de atender totalmente à solicitação prevista na cláusula quinta, item 5.2, alínea “g” e “h”, do presente instrumento contratual;

13.4. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Bayeux e os demais órgãos que compõem a Administração Municipal, por até 02 (dois) anos.

13.4.1. **Parágrafo primeiro** - O valor da multa, aplicado após regular processo administrativo, será descontado da CONTRATADA, observando-se os pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOCUMENTAÇÃO

14.1. A presente Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:

14.1.1. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00043/2022 – FMS-PMBEX;

14.1.2. Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00016/2022 – FMS-PMBEX e anexos;

14.1.3. Proposta Comercial da (s) FORNECEDORA (S): EQUIPASAÚDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, CNPJ: 34.836.183/0001-00;

14.1.4. Ata(s) da(s) sessão(ões) circunstanciada(s) do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00016/2022 – FMS-PMBEX.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1. Para dirimir as questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Vara da Fazenda Pública, no Foro da cidade de Bayeux/PB, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso I, alínea “d” da Constituição Federal. Nada mais havendo a tratar, lavrada a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pela gestora constitucional do ÓRGÃO GERENCIADOR, na qualidade de Gerenciadora e pelo (s) particular (es) fornecedor(es).



ROSIENE SARINHO SOARES RIBEIRO
GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERENCIADOR DA ARP

BAYEUX
GOVERNO MUNICIPAL



EQUIPASAÚDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CNPJ: 34.836.183/0001-00
EMPRESA DETENTORA DA ARP

EQUIPASAÚDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CNPJ: 34.836.183/0001-00
Avenida Feliciano Batista de Amorim
nº 1116 - Bairro: Juá
Guarabira-PB - Cep: 58.200-000



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022 – FMS-PMBEX

EXTRATO DE ARP Nº 00037/2022 – FMS – PMBEX E SUA PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA OFICIAL:

- **DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO**
- **DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO**
 - **PORTAL DA TRANSPARÊNCIA**



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
SECRETARIA DA SAÚDE

GABINETE DA SECRETARIA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00037/2022 – FMS-PMBEX

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX - PB, através do(a) gestor(a) desta edilidade, de acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00016/2022 – FMS-PMBEX concernente ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00043/2022 – FMS-PMBEX, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE APARELHO DE RAIOS X, DIGITALIZADOR DO TIPO CR E IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, publica o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS sendo que o prazo de validade é de um ano contado da data da assinatura da mesma e deste extrato, tendo sua eficácia através da publicação em imprensa oficial conforme fornecedor, itens, marcas e valores abaixo relacionados.

EMPRESA: EQUIPASAÚDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, CNPJ: 34.836.183/0001-00
ENDEREÇO: AV. FELICIANO BATISTA AMORIM, 1116, BAIRRO JUÁ, GUARABIRA-PB, CEP:
58.200-000, TEL.: (83) 3271-3480, E-MAIL: EQUIPASAÚDE@OUTLOOK.COM
VIGÊNCIA: 10 DE MAIO DE 2022 ATÉ 10 DE MAIO DE 2023

LOTE ÚNICO						
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNID	FABRICANTE/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	RAIO X HOSPITALAR FIXO 600MA: MESA DE COMANDO: Mesa de comando microprocessada com teclado Soft-touch e display de LCD modelo Big Number para uma fácil leitura dos parâmetros radiológicos. Tecla de liga/desliga Teclado com comando duplo de seleção de Kv, kV maior com variação em passos de 10kV aproximadamente kV menor com variação em passos de 2kV aproximadamente Seleção de tempo em 21 passos variando de 0,04s a 3,2 s Seleção de mA com os seguintes valores Foco fino: 50 /100 mA Foco grosso : 200 / 320 /400 / 500/ 630 mA Seleção automática de foco conforme a escala de corrente selecionada Seleção de Postos de Trabalho: Coluna(sem Bucky) Bucky1 (Bucky mural) Bucky2 (mesa Bucky) Teclapara disparo de Raios – X; Tecla para preparo de RX Demais características Circuito de estabilização de voltagem para filamento de ampola; Bloqueio de técnicas de operações prejudiciais a ampola; Aviso sonoro e luminoso em caso de bloqueios e durante a exposição. TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO: Rendimento de 630 mA / 125 KV; lmerso em óleo isolante especial, tratado a vácuo; Unidades retificadoras de silício para 125 KVp onda completa; Receptáculo Universal tipo "Federal Standard". CABOS DE ALTA TENSÃO: 01 Par de Cabos de Alta	01	UND	SHR/SH 600F	R\$ 144.000,00	R\$ 144.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
SECRETARIA DA SAÚDE

<p>Tensão; Capacidade 150 Kvp, com terminais de conexões Universal tipo "Federal Standard". AMPOLA PRODUTORA DE RAIOS – X: Tubo de anodo giratorio (30 / 50 KW) angulação de 16 graus; Capacidade máxima de armazenamento de calor: 190kHU; Dissipação térmica contínua máxima: 490 W ; Filamento: Foco Fino: 1,0/ 1,0 mm, Foco Grosso: 2,0/ 2,0 mm, Cúpula Radiação de fuga: < 0,5 mGy/h / 125 kV, Conexão tipo Federal. Cargas máximas permitidas: 630mA / 80kV, 500 mA / 90 KV 100 mA / 115 KV, 300 mA / 100 KV 50 mA / 125 KV, 200 mA / 110 KV. COLIMADOR LUMINOSO: Caixa com revestimento em chumbo. Lâminas em 1 estágio. Lâmpada halógena de 24 volts. Contraste superior a 3:1 Temporizador eletrônico para centralização. COLUNA PORTA TUBO: Coluna porta tubo dotada de freios eletromagnéticos acionados por meio de teclas. Indicador de angulação, braço telescópico com giro de 180 graus. Coluna co base giratória contrabalançada com deslocamento sobre trilho, sistema chão / chão dotado de freios eletromagnéticos. Braço de sustentação do Tubo com movimento de avanço e retrocesso com freio magnético. ESTATIVA BUCKY MURAL: Coluna contrabalançada para fixação em chão. Freios mecânicos e eletromagnéticos. Grade anti-difusora 10.1-150 linhas, com distância focal 1,80 mts. Bandeja ajustável em aço inox polido para chassis 13X18 até 35X43 cm. Ligação conjugada com o Comando do equipamento com disparo de Raios– X automático. MESA RADIOLÓGICA: Mesa Bucky TAMPO FLUTUANTE com movimentos longitudinais e transversais provida de freio magnético, com acabamento em pintura eletrostática, tampo em fórmica e acabamento em alumínio A-7, provida de bucky com gaveta em aço inox polido e percurso em toda sua extensão. Grade anti-difusora 10.1-150linhas. ALIMENTAÇÃO DE REDE: 220 – Volts– Hz/ Bifásico. EXAMES QUE PODERÃO SER REALIZADOS COM ESTE APARELHO: Radiografia convencional. Traumatologia e Ortopedia em geral. Incidências Oblíquas (todas). Urografia escretora. Vias Biliares. Seios da Face Mastóide. Dissipação térmica contínua máxima: 490 W ; Filamento: Foco Fino: 1,0/ 1,0 mm, Foco Grosso: 2,0/ 2,0 mm; Cúpula Radiação de fuga: < 0,5 mGy/h / 125 kV, Conexão tipo Federal. Cargas máximas permitidas: 630mA / 80kV, 500 mA / 90 KV 100 mA / 115 KV, 300 mA / 100 KV 50 mA / 125 KV, 200 mA / 110 KV. COLIMADOR LUMINOSO: Caixa com revestimento em chumbo. Lâminas em 1 estágio. Lâmpada halógena de 24 volts. Contraste superior a 3:1 Temporizador eletrônico para centralização. COLUNA PORTA TUBO:</p>					
---	--	--	--	--	--

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
SECRETARIA DA SAÚDE

	<p>Coluna porta tubo dotada de freios eletromagnéticos acionados por meio de teclas. Indicador de angulação, braço telescópico com giro de 180 graus. Coluna co base giratória contrabalançada com deslocamento sobre trilho, sistema chão / chão dotado de freios eletromagnéticos. Braço de sustentação do Tubo com movimento de avanço e retrocesso com freio magnético. ESTATIVA BUCKY MURAL: Coluna contrabalançada para fixação em chão. Freios mecânicos e eletromagnéticos. Grade anti-difusora 10.1-150 linhas, com distância focal 1,80 mts. Bandeja ajustável em aço inox polido para chassis 13X18 até 35X43 cm. Ligação conjugada com o Comando do equipamento com disparo de Raios- X automático. MESA RADIOLÓGICA: Mesa Bucky TAMPO FLUTUANTE com movimentos longitudinais e transversais provida de freio magnético, com acabamento em pintura eletrostática, tampo em fórmica e acabamento em alumínio A-7, provida de bucky com gaveta em aço inox polido e percurso em toda sua extensão. Grade anti-difusora 10.1-150linhas. ALIMENTAÇÃO DE REDE: 220 – Volts– Hz/ Bifásico. EXAMES QUE PODERÃO SER REALIZADOS COM ESTE APARELHO: Radiografia convencional. Traumatologia e Ortopedia em geral. Incidências Oblíquas (todas). Urografia escretora. Vias Biliares. Seios da Face Mastóide. INSTALAÇÃO E TREINAMENTO INCLUSO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA VIGENTE.</p>				
02	<p>CR DIGITALIZADOR DE IMAGEM: Sistema de digitalização de imagens de alta resolução, com alimentador mono cassete, com possibilidade de resolução de 06 pixels/mm em modo padrão e 12 pixels/mm em alta resolução. O sistema digitalizador deverá possuir capacidade de: Reconhecer automaticamente o tamanho e tipo do cassete; Reconhecer automaticamente o tamanho e tipo do cassete; 35x43cm, em resolução padrão; ESTAÇÃO DE TRABALHO para imagens de Raios X: Conter software de processamento de exames de Raios-X e software adicional de pós-processamento de imagens que permita, a critério do operador e de forma manual ou automática, incrementar o contraste da imagem. Efetuar automaticamente o enegrecimento da borda da imagem digitalizada que não recebeu radiação. Ferramentas de ajustes de brilho, contraste, índice de exposição, medidas de distâncias, ângulos, rotação, inversão, zoom e formatação de imagens para impressão. Suprimir automaticamente linhas de grades nas imagens. Marcar automaticamente imagens que foram rotacionadas e invertidas. Efetuar</p>	01	UND	<p align="center">CARESTREAM / DIRECTVIEW VITA FLEX</p>	<p align="center">R\$ 116.000,00</p> <p align="center">R\$ 116.000,00</p>

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
SECRETARIA DA SAÚDE

	<p>conexão DICOM 3.0 para impressão Print. Possibilitar ao operador a capacidade de escolher multi layouts de impressão para permitir economia de filmes. Permitir o cadastramento de imagens de Raios-X e sistema de identificação integrado ao terminal, para cadastramento dos cassetes. Permitir comunicação e arquivamento de, no mínimo, 2.000 imagens na forma online. Armazenar e distribuir imagens em formatos DICOM 3.0 com níveis de visualizações (diagnóstica e referência) via rede existente, em TCP/IP, LAN e WAN. 2 Cassetes + Placa de fósforo 35 x 43 cm para radiologia computadorizada; Software baseado em plataforma WEB, com disponibilização de, no mínimo, 4 pontos de acesso remoto e simultâneos para visualização das imagens via intranet ou internet (WEB VIEWER). Capacidade para gravação de imagens em DVD em formato que permita sua visualização em um PC padrão, sem necessidade de software adicional. Possibilitar uso de senhas individuais de acesso, com definição de privilégios, para proteção de dados confidenciais. Possuir software Multilayout, Possibilitando ao operador a capacidade de formatar a impressão de, no mínimo, 04 imagens de resolução diagnóstica na mesma película e selecionar tamanhos diferentes de película, podendo ser de formatos e tamanhos diferentes. PC/MONITOR: PLACA MAE 1150 PCWARE IPMH81G1 DDR3, PROCESSADOR 1150 INTEL CORE I5 4460 3.20GHZ 6MB, MEMÓRIA 8GB DDR3 1600MHZ, HD 1TB WD BLUE 7200RPM SATA3, GABINETE, WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS, TECLADO/MOUSE. NO-BREAK'S 2 KVA SENOIDAIS DUPLA CONVERSÃO: ENTRADA/SAÍDA: 220V ou BIVOLT, ON-LINE- SÉRIE COM SAÍDA SENOIDAL; DISTORÇÃO HARMÔNICA TDH <5%, PFC E CARGA NÃO LINEAR; FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 Hz +/- 5%, REGULAÇÃO NORMAL : +/- 2%, REGULAÇÃO NA BATERIA: +/- 3%, POSSUIR TRANSFORMADOR ISOLADOR. INSTALAÇÃO E TREINAMENTO INCLUSO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA VIGENTE.</p>					
03	<p>IMPRESSORA COM TECNOLOGIA de impressão LASER a seco (DRY): Sistema de Imagem Direta Digital tecnologia de impressão a laser: Possua resolução mínima de 320 DPI e tecnologia de impressão a laser; Processamento de no mínimo 40 filmes por hora, do tamanho 35x43 cm; Imprimir filmes nos tamanhos 20x25cm, 25x30cm, 28x35cm e 35x43cm; O equipamento deverá ser DICOM NATIVO, ou seja, sem a necessidade de acessórios externos (print server) para conversão do sinal ao padrão DICOM</p>	01	UND	CARESTREAM / DRYVIEW 5700	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00




ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
SECRETARIA DA SAÚDE

3.0; Permitir conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0 e Ethernet TCP/IP; Alimentação 220 volts, 60 Hertz. INSTALAÇÃO E TREINAMENTO INCLUSO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA VIGENTE.					
VALOR GLOBAL:					R\$ 291.000,00
(DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL REAIS)					

Bayeux - PB, 10 de Maio de 2022.

ROSIENE SARINHO SOARES RIBEIRO
GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

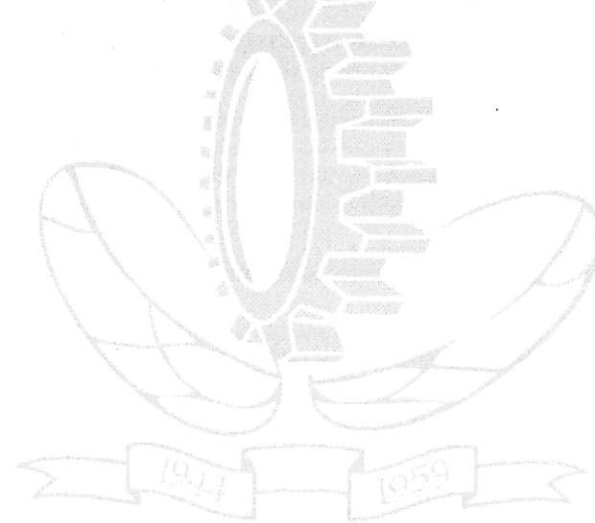

BAYEUX
GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
SECRETARIA DA SAÚDE
GABINETE DA SECRETARIA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 00037/2022 – FMS-PMBEX

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX - PB, através do(a) gestor(a) desta edilidade, de acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00016/2022 – FMS-PMBEX concernente ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00043/2022 – FMS-PMBEX, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE APARELHO DE RAIOS X, DIGITALIZADOR DO TIPO CR E IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, publica o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS sendo que o prazo de validade é de um ano contado da data da assinatura da mesma e deste extrato, tendo sua eficácia através da publicação em imprensa oficial conforme fornecedor, itens, marcas e valores abaixo relacionados. EMPRESA: EQUIPASAÚDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, CNPJ: 34.836.183/0001-00 ENDEREÇO: AV. FELICIANO BATISTA AMORIM, 1116, BAIRRO JUÁ, GUARABIRA-PB, CEP: 58.200-000, TEL.: (83) 3271-3480, E-MAIL: EQUIPASAUDE@OUTLOOK.COM VIGÊNCIA: 10DE MAIODE 2022 ATÉ 10DE MAIODE 2023

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNID.	FABRICANTE/ MODELO	VALOR UNID.	VALOR TOTAL	
01	<p>RAIO X HOSPITALAR TIPO 600MA; MESA DE COBRANDO Mesa de comando manual processada em tecido Soft-touch e display de LCD modelo Dig Number para uma fila leituras dos parâmetros radiológicos. Tela de ligatidade. Teclado com comando duplo de seleção de KV, KV manual com variação em passos de 10kV Aproximadamente 4V menor com variação em passos de 2kV aproximadamente. Seleção de tempo em 21 passos variando de 0,06 a 3,2 s Seleção de mA com os seguintes valores: Foco fino: 50/100 mA Foco grosso: 200 / 320 /400 / 500 /600 mA Seleção automática de foco conforme a escala de corrente selecionada Seleção de Posição de Trabalho: Colimacao (Backy) Backy1 (Backy manual) Backy2 (nono Backy) 1 (colimador de Raio - X). Tela para preparo de RX (Banco características Circuito de estabilização de voltagem para filtramento de raios, Bloqueio de técnicas de operações prejudiciais a ampola, Aviso sonoro e luminoso em caso de bloqueio e durante a exposição, TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO: Retalhamos de 630 mA / 125 KV; Imenso em óleo isolante especial, tratado a vácuo; Unidades retilificadoras de sílica para 125 KV; ondo complexo. Receptáculo Universal tipo "Federal Standard" CABOS DE ALTA TENSÃO: 01 Par de Cabos de Alta Tensão; Capacidade: 150 KV; com terminais de conexão Universal tipo "Federal Standard"; AMPOLA PRODUTORA DE RAIOS - X: Tubo de anodo giratório (30 / 50 KW) angulação de 16 graus, Capacidade máxima de amarracimento de cáter: 190kV; Dissipação térmica ótima máxima: 400 W ; Filamento: Foco Fino: 1,0 / 1,0 em; Foco Grosso: 2,0 / 2,0 mm, Cúpula Radiológica de Iga = 0,5 mcy/8 / 125kV, Conexão tipo Federal. Carga máxima permitida: 60mA / 80kV, 500 mA / 60KV, 100 mA / 115 KV, 300 mA / 100KV, 50 mA / 125 KV, 200 mA / 110 KV. COLIMADOR LUMINOSO: Caixa com revestimento em chumbo, Lâminas em 1 eixos; Lâmpada halógena de 24 volts. Controle superior a 3.1 Temporizador eletrônico para centralização. COLUNA PORTA TUBO: Coluna porta tubo dotada de freios eletromagnéticos acionados por meio de teclas. Indicação de angulação, braço telescópico com giro de 180 graus. Coluna com base giratória centralizada com deslocamento sobre trilho, sistema chão / chão dotado de freios eletromagnéticos. Braço de sustentação do Tubo com movimento de alongo e retração com freio magnético. ESTÁTIVA BACKY MURAL: Coluna centralizada para fixação em chão. Fretos mecânicos e eletromagnéticos. Grade anti-choque 10 / 1-150 lótes, com distância focal 180 cm; Bloqueio quarter em aço inox polido para chassis 13X18 até 35X41 cm; Lâmpada equipada com o Comando de equipamento com display de Raio - X automático. MESA RADIOLOGICA: Mesa Backy TAMPO FLUOTANT com movimento longitudinal e transversal provido de freio magnético, com acionamento em pedala eletrônica, tempo em forma e acionamento em alavanca A-7, provido de backy com gaveta em aço inox polido e persiana em toda sua extensão. Grade anti-choque 15 / 1-150 lótes ALIMENTAÇÃO DE REDE: 220 - Volts - Hz Bólidos EXAMES QUE PODERÃO SER REALIZADOS COM ESTE APARELHO: Radiografia convencional. Tomografia e Ortopedia em geral. Incidência Oblíqua (obliq) Urogafia cisterna. Vão Biliária. Sero da Face Mastóide. Dissipação térmica contínua máxima: 400 W, Filamento: Foco Fino: 1,0 / 1,0 mm, Foco Grosso: 2,0 / 2,0 mm, Cúpula Radiológica de Iga = 0,5 mcy/8 / 125 kV; Conexão tipo Federal. Carga máxima permitida: 60mA / 80KV, 500 mA / 60KV, 100 mA / 115 KV, 300 mA / 100KV, 50 mA / 125 KV, 200 mA / 110KV. COLIMADOR LUMINOSO: Caixa com revestimento em chumbo. Lâminas em 1 eixos; Lâmpada halógena de 24 volts. Controle superior a 3.1 Temporizador eletrônico para centralização. COLUNA PORTA TUBO: Coluna porta tubo dotada de freios eletromagnéticos acionados por meio de teclas. Indicação de angulação, braço telescópico com giro de 180 graus. Coluna com base giratória centralizada com deslocamento sobre trilho, sistema chão / chão dotado de freios eletromagnéticos. Braço de sustentação do Tubo com movimento de alongo e retração com freio magnético. ESTÁTIVA BACKY MURAL: Coluna centralizada para fixação em chão. Fretos mecânicos e eletromagnéticos. Grade anti-choque 10 / 1-150 lótes, com distância focal 180 cm; Bloqueio quarter em aço inox polido para chassis 13X18 até 35X41 cm; Lâmpada equipada com o Comando de equipamento com display de Raio - X automático. MESA RADIOLOGICA: Mesa Backy TAMPO FLUOTANT com movimento longitudinal e transversal provido de freio magnético, com acionamento em pedala eletrônica, tempo em forma e acionamento em alavanca A-7, provido de backy com gaveta em aço inox polido e persiana em toda sua extensão. Grade anti-choque 15 / 1-150 lótes ALIMENTAÇÃO DE REDE: 220 - Volts - Hz Bólidos EXAMES QUE PODERÃO SER REALIZADOS COM ESTE APARELHO: Radiografia convencional. Tomografia e Ortopedia em geral. Incidência Oblíqua (obliq) Urogafia cisterna. Vão Biliária. Sero da Face Mastóide. INSTALAÇÃO E TREINAMENTO INCLUSO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA VIGENTE.</p>				SHR,SEI 600F	R\$ 144.000,00	R\$ 144.000,00

02	<p>CR DIGITALIZADOR DE IMAGEM: Sistema de digitalização de imagens de alta resolução, com alimentador disco cassete, com possibilidade de resolução de 60 pixels/mm em modo padrão e 12 pixels/mm em alta resolução. O sistema digitalizador deverá possuir capacidade de: Reconhecer automaticamente o tamanho e tipo do cassete; Reconhecer automaticamente o tamanho e tipo do cassete; 35x43cm, em resolução padrão; ESTACAO DE TRABALHO para imagens de Raios X. Contar software de processamento de exames de Raios-X e software adicional de pós-processamento de imagens que permita, a critério do operador e de forma manual ou automática, incrementar o contraste da imagem; Efetuar automaticamente o enquadramento da borda da imagem digitalizada que não recebeu radiação; Ferramentas de ajustes de brilho, contraste, índice de exposição, medidas de distâncias, ângulos, rotacion, inversão, zoom e formatação de imagens para impressão; Seguir automaticamente linhas de grades nas imagens; Marcar automaticamente imagens que foram reticuladas e invertidas; Efetuar conexão DICOM 3.0 para impressão Print. Possibilitar ao operador a capacidade de escolher multi layouts de impressão para permitir economia de filmes. Permitir o cadastramento de imagens de Raios-X e sistema de identificação integrado ao terminal, para cadastramento dos exames. Permitir comunicação e arquivamento de, no mínimo, 2.000 imagens na forma online. Armazenar e distribuir imagens via formato DICOM 3.0 com níveis de visualização (diagnóstica e referencial) via rede existente, em TCP/IP, LAN e WAN. 2 Cassetes + Placa de filme 35 x 43 cm para radiologia computadorizada. Software baseado em plataforma WEB, com disponibilização de, no mínimo, 4 pontos de acesso remoto e simultânea para visualização das imagens via internet ou internet (WEB VIEWER). Capacidade para gravação de imagens em DVD em formato que permita sua visualização em um PC padrão, sem necessidade de software adicional. Possibilitar uso de senhas individuais de acesso, com definição de privilégios, para proteção de dados confidenciais. Possuir software Multilayout, Possibilitando ao operador a capacidade de formatar a impressão de, no mínimo, 04 imagens de resolução diagnóstica na mesma página e selecionar tamanho e formatos de página, podendo ser de formatos e tamanhos diferentes. PC/MONITOR: PLACA MAE: 1150 PCWARE IBM/IGI DOR3, PROCESSADOR: 1190 INTEL CORE I3 4460 3.20GHZ 6MB MEMORIA RGB DOR3 1600MHz, HD 1TB WD BLUE 7200RPM SATA3, GABINETE, WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS, TECLADONOUSE: NO-BREAKS 2 KVA SINGELAS DUPLA CONVERSÃO ENTRADA SAIDA: 220V ou BIVOLT ONLINE- SÉRIE COM SAIDA SINUSOIDAL. DISTRIBUIÇÃO HARMONICA THDI < 5%, PFC E CARGA NÃO LINEAR, FREQUENCIA NOMINAL: 60 Hz +/- 5%, REGULACAO NORMAL: +/- 2%, REGULACAO NA BATERIA: +/- 3%, POSSUIR TRANSFORMADOR REGULADOR, INSTALACAO E TREINAMENTO INCLUSO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA VIGENTE.</p>						R\$ 116.000,00
03	<p>IMPRESSORA COM TECNOLOGIA DE impresso LASER a laser (DRY): Sistema de imagem Direta Digital tecnologia de impressão a laser: Passa resolução mínima de 320 DPI e tecnologia de impressão a laser. Resolução de no mínimo 40 filmes por hora, do tamanho 31x43 cm; Impreser filmes nos tamanhos 26x2cm, 25x30cm, 28x35cm e 35x43cm; O equipamento deverá ser DICOM NATIVO, ou seja, sem a necessidade de acessórios externos (j-net server) para conexão do sinal ao padrão DICOM 3.0; Permitir conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0 e Eternet TCP/IP; Alimentação 220 volts, 60 Hertz; INSTALAÇÃO E TREINAMENTO INCLUSO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA VIGENTE.</p>						R\$ 31.000,00
VALOR GLOBAL:							R\$ 291.000,00
(DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL REAIS)							

Bayeux - PB, 10de Maio de 2022.

ROSILENE SARINHO SOARES RIBEIRO
GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00129/2022 – FMS – PMBEX
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE APARELHO DE RAIOS X, DIGITALIZADOR DO TIPO CR E IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00016/2022 – FMS – PMBEX, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00043/2022 – FMS – PMBEX
DOTAÇÃO: NATUREZA DA DESPESA: 3390.00: 3390.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 10.122.3024.2093 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.302.3025.2184 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.
VIGÊNCIA: DE 10 DE MAIO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX - CNPJ Nº 08.924.581/0004-02
CONTRATADO: EQUIPASAÚDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, CNPJ: 34.836.183/0001-00
VALOR: R\$ 291.000,00 (DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL REAIS)

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00130/2022 – PMBEX
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KIT BEBÊ PARA ATENDER

PORTARIA nº582/2022

Bayeux, 13 de abril de 2022

A Prefeita Constitucional do Município de Bayeux, Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais conferidas pelos arts. 8º e 9º do Decreto nº 54/2020, referente a indicação dos membros da Comissão Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente:

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, **JEOVÂNIA ANDRADE COSTA DE QUEIROZ**, como Presidente e membro Titular da Comissão do Fundo, e **YURI SALES MARINHO** como Vice-Presidente da Comissão do Fundo, ambos representantes da Secretaria de Meio Ambiente, até ulterior deliberação.

Art. 2º Nomear, **RAISSA FIAMMA MEIRELES ANDRADE** como Secretária Administrativa da Comissão do Fundo, sendo representante da Secretaria de Meio Ambiente, até ulterior deliberação.

Art. 3º Nomear, **RAFAEL DE FREITAS OLIVEIRA** como membro Titular da Comissão do Fundo, sendo representante da Secretaria de Meio Ambiente, até ulterior deliberação.

Art. 4º Nomear, **DANILO DA SILVA SANTOS** como membro Titular da Comissão do Fundo, sendo representante da Secretaria de Segurança, até ulterior deliberação.

Art. 5º Nomear, **ANTONIO HENRIQUE MARTINS CARNEIRO CUNHA** como membro Titular da Comissão do Fundo, sendo representante da Secretaria de Planejamento, até ulterior deliberação.

Art. 6º Nomear, **LENINE DE CARVALHO FONTES DA SILVA** como membro Titular da Comissão do Fundo, sendo representante da Secretária de Meio Ambiente, até ulterior deliberação.

Art. 7º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

Luciene Andrade Gomes Martinho
LUCIENE ANDRADE GOMES MARTINHO
 Prefeita de Bayeux

LICITAÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00129/2022 – FMS – PMBEX

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE APARELHO DE RAIOS X, DIGITALIZADOR DO TIPO CR E IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00016/2022 – FMS – PMBEX, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00043/2022 – FMS – PMBEX
 DOTAÇÃO: NATUREZA DA DESPESA: 3390 00: 3390.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 10.122.3024.2093 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.302.3025.2184 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.

VIGÊNCIA: DE 10 DE MAIO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX - CNPJ Nº 08.924.581/0004-02

CONTRATADO: EQUIPASAÚDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, CNPJ: 34.836.183/0001-00

VALOR: R\$ 291.000,00 (DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL REAIS)



ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
 SECRETARIA DA SAÚDE

GABINETE DA SECRETARIA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00037/2022 – FMS-PMBEX

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX - PB, através do(a) gestor(a) desta edildade, de acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00016/2022 – FMS-PMBEX concernente ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00043/2022 – FMS-PMBEX, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE APARELHO DE RAIOS X, DIGITALIZADOR DO TIPO CR E IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, publica o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS sendo que o prazo de validade é de um ano contado da data da assinatura da mesma e deste extrato, tendo sua eficácia através da publicação em imprensa oficial conforme fornecedor, itens, marcas e valores abaixo relacionados.

EMPRESA: EQUIPASAÚDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, CNPJ: 34.836.183/0001-00
 ENDEREÇO: AV. FELICIANO BATISTA AMORIM, 1116, BAIRRO JUÁ, GUARABIRA-PB, CEP: 58.200-000, TEL: (83) 3271-3480, E-MAIL: EQUIPASAUDE@OUTLOOK.COM
 VIGÊNCIA: 10 DE MAIO DE 2022 ATÉ 10 DE MAIO DE 2023

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	LOTE ÚNICO		FABRICANTE/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		QUANT.	UNID.			
01	RAIO X HOSPITALAR FIM 600MA: MESA DE COMANDO: Mesa de comando microprocessada com teclado soft touch e display de LED multi-touch number para uma fácil leitura dos parâmetros radiológicos. Tecla de liga/desliga Teclado com comando duplo de seleção de Kv, kV maior com variação em passos de 25kV aproximadamente kV menor com variação em passos de 25V aproximadamente Seleção de tempo em 21 passos variando de 0,04s a 3,2 s Seleção de mA com os seguintes valores Foco fino: 50 /200 mA Foco grosso: 200 / 320 /400 / 500/ 630 mA Seleção automática de foco conforme a escala de corrente selecionada Seleção de Postos de Trabalho: Coluna(em Bucky) Bucky (Bucky mural) Bucky (mesa Bucky) Teclapadrão para Raios - X Tecla para preparo de RX Demais características Circuito de estabilização de voltagem para filamento de ampola; Bloqueio de técnicas de operações prejudiciais a ampola; Aviso sonoro e luminoso em caso de bloqueios e durante a exposição; TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO: Rendimento de 830 mA / 125 KV; imerso em óleo isolante especial, tratado a vácuo; Unidades retificadoras de silício para 125 KV onda completa; Receptáculo Universal tipo "Federal Standard"; CABOS DE ALTA TENSÃO: 01 Par de Cabos de Alta Tensão; Capacidade 150 KV; com terminais de cores Universal tipo "Federal Standard".	01	UND	SHR/SH 600F	R\$ 144.000,00	R\$ 144.000,00

PRODUTORA DE RAIOS - X. Tubo de anodo giratório (30 / 50 KW) angulação de 15 graus; Capacidade máxima de armazenamento de calor: 150KJHU; Dissipação térmica contínua máxima: 490 W ; Filamento: Foco Fino: 1,0/ 1,0 mm, Foco Grosso: 2,0/ 2,0 mm. Cúpula Radiação de fuga: < 0,5 mGy/h / 125 KV, Conexão tipo Federal. Cargas máximas permitidas: 630mA / 80kV, 500 mA / 90 KV 100 mA / 115 KV, 300 mA / ,00 KV 50 mA / 125 KV, 200 mA / 110 KV. COLIMADOR LUMINOSO: Caixa com revestimento em chumbo. Lâminas em 1 estágio. Lâmpada halógena de 24 volts. Contraste superior a 3:1 Temporizador eletrônico para centralização. COLUNA PORTA TUBO: Coluna porta tubo dotada de freios eletromagnéticos acionados por meio de teclas. Indicador de angulação, braço telescópico com giro de 180 graus. Coluna co base gradatória contrabalançada com deslocamento sobre trilho, sistema chão / chão dotado de freios eletromagnéticos. Braço de sustentação do tubo com movimento de avanço e retrocesso com freio magnético. ESTATIVA BUCKY MURAL: Coluna contrabalançada para fixação em chão. Freios mecânicos e eletromagnéticos. Grade anti-difusora 10:1-150 linhas, com distância focal 1,80 mts. Bandeja ajustável em aço inox polido para chassis 13X18 até 35X43 cm. Ligação conjugada com o Comando do equipamento com disparo de Raios - X automática. MESA RADIOLOGICA: Mesa Bucky TAMPO - FLUTUANTE com movimentos longitudinais e transversais provida de freio magnético, com acabamento em pintura eletrostática, tampo em fôrmica e acabamento em alumínio A-7, provida de bucky com girante em aço inox polido e perçasso em toda sua extensão. Grade anti-difusora 10:1-150linhas. ALIMENTAÇÃO DE REDE: 220 - Volts- Hz/ Básico. EXAMES QUE PODERÃO SER REALIZADOS COM ESTE APARELHO: Radiografia convencional; Traumatologia e Ortopedia em geral; Incidências Oclílicas (todas); Urografia excretora. Vias biliares. Seios da Face Mastóide Dissipação térmica contínua máxima: 490 W ; Filamento: Foco Fino: 1,0/ 1,0 mm, Foco Grosso: 2,0/ 2,0 mm; Cúpula Radiação de fuga: < 0,5 mGy/h / 125 KV, Conexão tipo Federal. Cargas máximas permitidas: 630mA / 80kV, 500 mA / 90 KV 100 mA / 115 KV, 300 mA / 100 KV 50 mA / 125 KV, 200 mA / 110 KV. COLIMADOR LUMINOSO: Caixa com revestimento em chumbo. Lâminas em 1 estágio. Lâmpada halógena de 24 volts. Contraste superior a 3:1 Temporizador eletrônico para centralização. COLUNA PORTA TUBO: Coluna porta tubo dotada de freios eletromagnéticos acionados por meio de teclas. Indicador de angulação, braço telescópico com giro de 180 graus. Coluna co base gradatória contrabalançada com deslocamento sobre trilho, sistema chão / chão dotado de freios eletromagnéticos. Braço de
--

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO –
TERCEIRA CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2022 – FMS - PMBEX
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00018/2022 – FMS - PMBEX**

A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bayeux, através de sua Pregoeira Oficial torna público para conhecimento dos interessados que a TERCEIRA CHAMADA da licitação em epígrafe, objetivando a realização de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE APARELHO TOMÓGRAFO, DIGITALIZADOR DO TIPO CR COM CASSETES INCLUSOS E IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, com abertura prevista para o último dia 11 de Maio de 2022 às 09h00min (horário de Brasília/DF), fica **ADIADA para o dia 25 de Maio de 2022 às 09h00min (horário de Brasília/DF)** em razão do provimento parcial de Impugnação ao Edital apresentado pela empresa SOLUÇÃO MÉDICA EIRELI. CNPJ; 21.060.578/0001-03. A sessão pública será realizada através do Site: <https://www.portaldecomprasbayeux.com.br/>, Cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Bayeux (<https://www.bayeux.pb.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes/>). Maiores informações poderão ser obtidas por e-mail (licitacaobayeux@gmail.com), a partir da publicação deste aviso.

Bayeux - PB, 12 de Maio de 2022.

ALICE SOARES DA SILVA
Pregoeira Oficial/PMBEX

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL**

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 00185/2020-FMS-PMBEX
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, IMUNO-HORMÔNIO, UROANÁLISE E COAGULAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORNECIMENTO DE REAGENTES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, GERENCIAMENTO E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICÍPIO DE BAYEUX-PB.
CONTRATANTE: SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX
CONTRATADA: CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA. CNPJ: 04.666.364/0001-66
PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00025/2020 – FMS – PMBEX/PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00109/2020 – FMS – PMBEX
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 02 MESES
VIGÊNCIA: 01/05/2022 A 01/07/2022.
ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO AO CONTRATO POR MAIS 02 (DOIS) MESES, PASSANDO DE 01/03/2022 A 01/05/2022 PARA 01/05/2022 A 01/07/2022. PERFAZENDO O PRAZO TOTAL DE 19 (DEZENOVE) MESES, CONSIDERADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO ORIGINAL.

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO**

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00007/2020 – PMBEX
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA LIBERDADE, Nº 3682-B, CENTRO, BAYEUX-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E A SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL – SETRAS.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00007/2020 – PMBEX; PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00045/2020 – PMBEX
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX.
CONTRATADO: FURTADO LIMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ: 04.489.679/0001-85
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
VIGÊNCIA: DE 10/04/2022 A 10/04/2023
ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE PRAZO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PASSANDO DE 10 DE ABRIL DE 2021 A 10 DE ABRIL DE 2022 PARA 10 DE ABRIL DE 2022 A 10 DE ABRIL DE 2023, PERFAZENDO O PRAZO TOTAL DE 36 (TRINTA E SEIS MESES) MESES, CONSIDERADOS DA DATA INICIAL DA ASSINATURA DO REFERIDO INSTRUMENTO.
O VALOR DE REAJUSTE CONTRATUAL MENSAL DE R\$ 8.625,00 PASSA PARA R\$9.898,00 E O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R\$ 113.500,00 PARA R\$ 118.776,00.

<p>contém: tubo com movimento de avanço e retrocesso com freio magnético. ESTATIVA BUCKY MURAL: Coluna contrabalancada para fixação em chão. Freios mecânicos e eletromagnéticos. Grade antidifusora 101 150 fendas, com distância focal 1.80 mts. Bandeira ajustável em aço inox polido para chassis 13X18 até 35x43 cm. Ligação controlada com o Comando do equipamento com display de Kiosco- R automático. MELIA RADIOLOGICA. Ectra Bucky TAMPO. FEULIANT com raios mltiplos longitudinais e transversais. prorde de freio magnético, com acabamento em pintura eletrostática, tampos em alumínio e acabamento em alumínio A 7. prorde de bucky com pavela em aço inox polido e persivo em toda sua extensão. Grade antidifusora 101 150 fendas. ALIMENTAÇÃO DE REDE 220 Volts. MF/ Bússola EXAMES QUE PODERÃO SER REALIZADOS COM ESTE APARELHO: Radiografia convencional. Traumatologia e Ortopedia em geral. incidências Oblíquas (todas). Urografia excretora. Vias Biliares. Seno da Fave Mastóide. INSTALAÇÃO E TREINAMENTO INCLUSO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA VIGENTE.</p>				
<p>02 CR DIGITALIZADOR DE IMAGEM: Sistema de digitalização de imagens de alta resolução, com alimentador mono cassette, com possibilidade de resolução de 06 pixels/mm em modo padrão e 12 pixels/mm em alta resolução. O sistema digitalizador deverá possuir capacidade de reconhecer automaticamente o tamanho e tipo do cassette, reconhecer automaticamente o tamanho e tipo do cassette, 35x43cm, em resolução padrão, ESTACÃO DE TRABALHO para imagens de Raio-X. Control software de processamento de exames de Raio-X e software adicional de pós processamento de imagens que permita a crítica do operador de forma manual ou automática, incrementa o contraste da imagem. Utilizar automaticamente o enegrecimento da borda da imagem digitalizada que não recebeu radiação. Ferramentas de ajustes de brilho, contraste, índice de exposição, medidas de ângulos, ângulos, rotação, inversão, zoom e formatação de imagens para impressão. Suprimir automaticamente linhas de grades nas imagens. Marcar automaticamente imagens que foram rotacionadas e invertidas. Utilizar conexão DICOM 3.0 para impressão. Permitir ao operador a capacidade de escolher multi layouts de impressão para permitir economia de fitas. Permitir o cadastramento de imagens de Raio-X e sistema de identificação integrado ao terminal, para cadastramento das cassetes. Permitir comunicação e arquivamento de no mínimo, 2 DIC-imagens na forma on-line. Armazenar e distribuir imagens em formatos DICOM 3.0 com níveis de visualização (diagnóstica e referencial) via rede existente em TCP/IP, LAN e WAN. 2 Cassetes e placa de furo 35 x 43 cm para radiografia computadorizada. Software baseado em plataforma WEB, com disponibilização de no m-nimo, 4 pontos de acesso remoto e simultâneo para visualização das imagens via intranet ou internet (WEB SERVER). Capacidade para impressão de imagens em DVD em formato que permita sua visualização em um PC padrão, sem necessidade de software adicional. Possibilitar uso de senhas individuais de acesso, com definição de privilégios, para proteção de dados confidenciais. Possuir software Multilíngua. Possibilitando ao operador a capacidade de formatar a impressão de, no mínimo, 04 imagens de resolução diagnóstica na mesma película e selecionar tamanhos diferentes de película, podendo ser de formatos e tamanhos diferentes. PC/MONITOR: PLACA MAE 1150. PC/WARE: IPR481G1 DDR3. PROCESSADOR 1150 INTEL CORE I5 4460. 3.20GHZ 6MB MEMORIA 8GB DDR3 1600MHz. HD 1TB WD BLUE 7200RPM SATA3. CABINETE, WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS. TECLADO/MOUSE NO-ARABAS 2 IVA SENODAS DUPLA CONVERSÃO ENTRADA/SAÍDA: 220V ou 110VOLT, ON-LINE, SÉRIE COM SAÍDA SENODAL, DISTORÇÃO HARMÔNICA THD <5%, PFC E CARREGA NÃO LINEAR, FREQUENCIA NOMINAL 60 Hz +/- 5%, REGULACAO NOMINAL +/- 2%, REGULACAO NA BATERIA +/- 3% POSSUIR TRANSFORMADOR ISOLADOR. INSTALAÇÃO E TREINAMENTO INCLUSO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA VIGENTE.</p>	<p>01 UNID</p>	<p>CARESTREAM / DIRECTVIEW VITA FLEX</p>	<p>R\$ 116.000,00</p>	<p>R\$ 116.000,00</p>
<p>43 cm para radiografia computadorizada. Software baseado em plataforma WEB, com disponibilização de no m-nimo, 4 pontos de acesso remoto e simultâneo para visualização das imagens via intranet ou internet (WEB SERVER). Capacidade para impressão de imagens em DVD em formato que permita sua visualização em um PC padrão, sem necessidade de software adicional. Possibilitar uso de senhas individuais de acesso, com definição de privilégios, para proteção de dados confidenciais. Possuir software Multilíngua. Possibilitando ao operador a capacidade de formatar a impressão de, no mínimo, 04 imagens de resolução diagnóstica na mesma película e selecionar tamanhos diferentes de película, podendo ser de formatos e tamanhos diferentes. PC/MONITOR: PLACA MAE 1150. PC/WARE: IPR481G1 DDR3. PROCESSADOR 1150 INTEL CORE I5 4460. 3.20GHZ 6MB MEMORIA 8GB DDR3 1600MHz. HD 1TB WD BLUE 7200RPM SATA3. CABINETE, WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS. TECLADO/MOUSE NO-ARABAS 2 IVA SENODAS DUPLA CONVERSÃO ENTRADA/SAÍDA: 220V ou 110VOLT, ON-LINE, SÉRIE COM SAÍDA SENODAL, DISTORÇÃO HARMÔNICA THD <5%, PFC E CARREGA NÃO LINEAR, FREQUENCIA NOMINAL 60 Hz +/- 5%, REGULACAO NOMINAL +/- 2%, REGULACAO NA BATERIA +/- 3% POSSUIR TRANSFORMADOR ISOLADOR. INSTALAÇÃO E TREINAMENTO INCLUSO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA VIGENTE.</p>				
<p>03 IMPRESSORA COM TECNOLOGIA de impressão LASER a seco (DR): Sistema de Imagem Direta Digital tecnologia de impressão a laser. Possui resolução mínima de 320 DPI e tecnologia de impressão a seco. Processamento de no mínimo 40 fímes por hora, do tamanho 35x43 cm. Imprima fímes nos tamanhos 20x25cm, 25x30cm, 28x35cm e 35x43cm. O equipamento deverá ser DICOM NATIVO, ou seja, sem a necessidade de acessórios externos (print server) para conversão no sinal ao padrão DICOM 3.0. Permite conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0 e Ethernet TCP/IP, alimentação 220 volts, 50 Hertz. INSTALAÇÃO E TREINAMENTO INCLUSO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA VIGENTE.</p>	<p>01 UNID</p>	<p>CARESTREAM / DRIVVIEW 5700</p>	<p>R\$ 31.000,00</p>	<p>R\$ 31.000,00</p>
<p align="right">VALOR GLOBAL:</p>				<p align="right">R\$ 291.000,00</p>
<p align="right">(DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL REAIS)</p>				

Bayeux - PB, 10 de Maio de 2022.

ROSIÊNÉ SARINHO SOARES RIBEIRO
GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE